BVI 6100 Mode d'emploi résumé

BladderScan™

1 Sélectionner le genre

(option « féminin » seulement en l'absence d'hystérectomie)

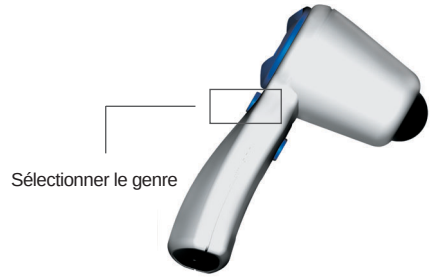

2 Appliquer un timbre gel Sontac


Sortir le timbre gel

Placer le timbre gel sur l'abdomen environ 5 cm au dessus de la symphyse pubienne


Placer l'appareil sur le timbre gel

3 Viser la vessie

(Incliner l'appareil en direction du coccyx)


Viser la vessie

4 Presser le bouton de mesure

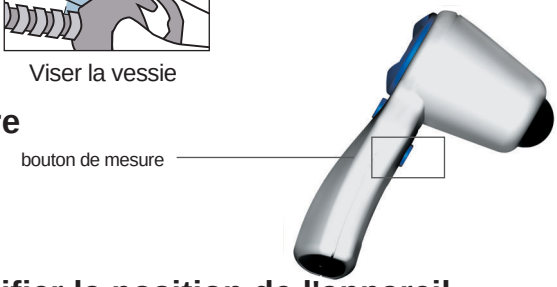

5 Vérifier le centrage

5A Flèches clignotantes = modifier la position de l'appareil

Flèches clignotantes


Par ex. : flèche clignotant vers la gauche, incliner l'appareil vers la gauche et mesurer à nouveau.

5B Flèches fixes ou absentes = accepter la mesure

Flèches fixes ou absentes

DIAGNOSTIC ULTRASOUND

www.dxu.com

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348 French 0900-0589

BVI 6100 Mode d'emploi résumé

BladderScan™

Si l'appareil est en veille, appuyer sur n'importe lequel des boutons pour l'activer.

1 Presser le bouton placé à côté de l'écran LCD pour sélectionner ou désélectionner l'option « femme ». Quand cette option est sélectionnée, une icône symbolisant un personnage féminin s'affiche à l'écran. N'utiliser cette option que pour une mesure chez une patiente n'ayant pas subi une hysterectomie ; dans tous les autres cas, presser le bouton jusqu'à disparition de l'icône.

2 2 Repérer la symphyse pubienne. Placer un timbre gel Sontac centré sur l'abdomen, à environ 5 cm au dessus de la symphyse pubienne

3 3 Positionner la tête de mesure (le dôme noir de l'appareil) sur le timbre gel Sontac, en direction de l'emplacement estimé de la vessie. En général, une légère inclinaison de l'appareil en direction du coccyx est nécessaire.

4 4 Appuyer et relâcher le bouton de mesure situé sous la poignée de l'appareil. Un symbole de mesure apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD pendant le temps de la mesure.

Tenir fermement l'appareil sans bouger jusqu'à la fin de la mesure.
Un bip signale la fin de la mesure et le volume mesuré s'affiche à l'écran.

5 Contrôler le bon angle de visée grâce aux flèches clignotantes à l'écran.

5A 5A. Si une flèche clignotante s'affiche à l'écran sous le volume mesuré, il est nécessaire de réajuster l'orientation de l'appareil dans la direction indiquée par la flèche. Imaginer le faisceau d'ultrasons sortant de l'appareil en direction du corps du patient. Si la flèche clignotante indique la gauche, orienter l'appareil pour que les ultrasons soient émis plus vers la gauche. Mesurer à nouveau. Répéter l'opération jusqu'à ce que la flèche ne clignote plus ou disparaisse.

5B Le volume vésical affiché est fiable lorsque la flèche ne clignote plus ou disparaît. Noter le volume vésical mesuré, l'appareil effaçant cette valeur de la mémoire dès la prochaine mesure. Il est recommandé de reproduire trois fois la mesure de valeurs proches pour confirmer la justesse de la mesure.

DIAGNOSTIC ULTRASOUND

www.dxu.com
For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348